


FORTALEZA, 17/06/2019
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PREZADOS SENHORES:

OBJETO:


Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGAÃO PRESENCIAL Nº 30.05.01/2019, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPB E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA LICITAÇÃO E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.




LOTE 01 - ASPIRADOR CIRÚRGICO								
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	V. UNT	V. TOTAL	VL. UNT Extenso	VL. TOTAL Extenso
1	ASPIRADOR CIRURGICO 5 LITROS - PARA UTILIZAÇÃO EM HOSPITAIS E CLINICAS, COM DESIGN ATUALIZADO, ERGONÔMICO E ROBUSTO, OFERECENDO PRATICIDADE NA UTILIZAÇÃO. ROBUSTEZ ADEQUADA PARA USO PROFISSIONAL HOSPITALAR, PERMITE VISUALIZAÇÃO E AJUSTE PELO OPERADOR SEM NECESSIDADE DE O MESMO CURVAR-SE. CARACTERÍSTICAS GERAIS APRESENTA FUNCIONAMENTO COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E MODO DE OPERAÇÃO CONTÍNUO/INTERMITENTE. SISTEMA DE PRODUÇÃO DE VÁCUO ACIONADO POR DIAFRAGMA EM BORRACHA NEOPRENE E MALHA DE NYLON, COM ALTA DURABILIDADE E ELIMINANDO AS SUPERFÍCIES DE FRIÇÃO. REGISTRO AGULHA EM AÇO INOX, DE PASSO FINO, PARA AJUSTE DE VÁCUO, PROPORCIONANDO SUAVE REGULAGEM DA SUÇÃO. MOTOR ELÉTRICO COM 1/2 CV, COM SISTEMA INTERNO DE EXAUSTÃO FORÇADA, VACUÔMETRO CALIBRADO ATÉ 30 POL. HG (760 MM HG). GRANDE E FÁCIL LEITURA. AJUSTE DE VÁCUO, ENTRE 0 E 22 POL. HG, FLUXO DE AR: 25 LITROS 1 MIN. ASPIRAÇÃO DE AGUA: 4 LITROS 1 MIN. VÁLVULA DE SEGURANÇA ACIONADA POR BOLA PARA BLOQUEIO DE ENTRADA DE SECREÇÃO NO CABEÇOTE. 1 ACIONAMENTO TOTALMENTE ISENTO DE 6160. CAIXA PLÁSTICA RESISTENTE PARA PROTEÇÃO DO MOTOR DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ABERTURA PARA SALDA DO SISTEMA DE EXAUSTÃO FORÇADA DO AR, EXTENSÃO EM PVC ATÓXICO COM 1,5M E DUAS CÂNULAS METÁLICAS PARA ASPIRAÇÃO. PÉS DERRAPANTES DE BORRACHA. SISTEMA DE VENTOSAS, JOGO COM 02 CÂNULAS SUPORTE PARA CÂNULAS ESPECIFICAÇÃO DO FRASCO 01 FRASCO COLETOR DE SECREÇÃO COM TAMPAS E VÁLVULA DE SEGURANÇA. INQUEBRÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 134°C. TAMPAS DO FRASCO FACILMENTE DESMONTÁVEL PARA PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA, COM SISTEMA DE VEDAÇÃO HERMÉTICA E VÁLVULA LIMITADORA DE SEGURANÇA PARA FRASCO CHEIO E EXTENSÃO COM ENGATE ATRAVES DE SISTEMA DE ROSCA. ESPECIFICAÇÃO DO SUPORTE (PEDESTAL) QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO DAIIS COM FREIO, PERMITINDO FÁCIL MOVIMENTAÇÃO. ESTRUTURA TUBULAR, PINTADO EM TINTA EPÓXI POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS, BIVOLT 220-110, INTERRUPTOR ACIONADO POR PEDAL, SISTEMA DE PROTEÇÃO, COM REARME AUTOMÁTICO PARA SUPERAQUECIMENTO DO MOTOR E SOBRECARGA NA REDE ELÉTRICA, MOD. A 45 PLUS	UND	1	OLIDEF	R\$ 3.072,73	R\$ 3.072,73	três mil e setenta e dois reais e setenta e três centavos	três mil e setenta e dois reais e setenta e três centavos
TOTAL DO LOTE 01						R\$ 3.072,73	três mil e setenta e dois reais e setenta e três centavos	

LOTE 02 - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO								
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	V. UNT	V. TOTAL	VL. UNT Extenso	VL. TOTAL Extenso
1	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO COM ECG/RESP/TEMP/OXIMETRIA/NIBP/ - MONITOR MODULAR DE TRANSPORTE A BEIRA DE LEITO QUE PERMITA POSSÍVEL ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, INTRODUÇÃO DE NOVAS MÓDULOS. TRANSFORMAÇÃO EM CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO. QUE NÃO NECESSITE DE MODIFICAÇÃO PROFUNDAS NO HARDWARE; CAPACIDADE DE APRESENTAR 4 CURVAS E TODOS OS DADOS ALFANUMÉRICOS; CAPACIDADE DE MONITORAR E PROCESSAR 7 PARÂMETROS. ARMAZENANDO-OS POR 24HORAS E APRESENTANDO-OS NA FORMA DE CURVA DE TENDÊNCIAS; BATERIA DE AUTONOMIA DE ATÉ 2 HORAS; SISTEMA 1 DE ALARME SONORO E VISUAL, ACEITANDO AJUSTES; PROGRAMA PARA CÁLCULO DE DOSAGEM DE DROGAS; SALDA PARA SINAL DE DESFIBRILAÇÃO COM SINCRONISMO; MONITORIZAÇÃO DE ECG COM DETECÇÃO DE COMPLEXOS QRS EM NO MÍNIMA 2 DERIVAÇÕES SIMULTANEAMENTE; MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA DE OXIMETRIA DE PULSO COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1 % NA OXIMETRIA PARA SATURAÇÃO E 1 BPM NA TAXA DE BATIMENTOS CARDÍACOS, APRESENTAÇÃO DE CURVA PLESTIMOGRAFICA, ALARMES SONOROS E VISUAIS DE MÁXIMO E MÍNIMA DE SP02 E PP. MONITORIZAÇÃO DE PRESSÃO SANGUÍNEA NÃO INVASIVA, TETA DE 12" LCD COLORIDO, TELA DE APOIO CLINICO, TECLAS DE ACESSO RÁPIDO, POSSIBILIDADE DE ACESSO REMOTO AS INFORMAÇÕES DO PACIENTE, COMUNICAÇÃO HL7. MOD. LOGICARE 12" B	UND	2	OLIDEF	R\$ 14.909,09	R\$ 29.818,18	quatorze mil, novecentos e nove reais e nove centavos	vinte e nove mil, oitocentos e dezoito reais e dezoito centavos
TOTAL DO LOTE 02						R\$ 29.818,18	vinte e nove mil, oitocentos e dezoito reais e dezoito centavos	

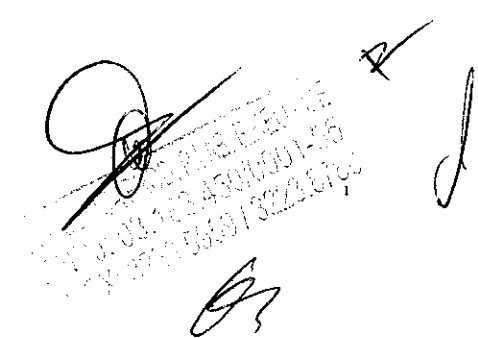



LOTE 03 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA								
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	V. UNT	V. TOTAL	VL. UNT Extenso	VL. TOTAL Extenso
1	<p>AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA CAPACIDADE 42 LITROS - EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, MÉDICAS, POSTOS DE SAÚDE E AMBULATÓRIOS, DENTRE OUTROS. DIMENSÕES INTERNAS (DIAM. X P): 30 X 60 CM; DIMENSÕES EXTERNAS (AXLXP): 51 X 60 X 77 CM; POTÊNCIA: 2400 WATTS N° DE BANDEJAS. 3; DIMENSÕES DA BANDEJA (LXP): 24 X 57 CM, PESO LÍQUIDO DO EQUIPAMENTO: 65 KG, TENSÃO (VOLTS): 220 V; COM VASO DE PRESSÃO EM FORMATE CILÍNDRICO, HORIZONTAL E CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 POLIDO COM ACABAMENTO SANITÁRIO E REVESTIDO EXTERNAMENTE COM MATERIAL ISOLANTE AO 1 CALOR, QUE ALÉM DE OTIMIZAR O SEU FUNCIONAMENTO, REDUZ O CONSUME DE ENERGIA E NÃO TRANSFERE CALOR AO AMBIENTE. PORTA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 FUNDIDO, COM ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA DE SILICONE RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. POSSUI DISPOSITIVO QUE IMPEDE O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO COM A PORTA ABERTA. SISTEMA DE FECHAMENTO DA PORTA SEGURO, CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL E DOTADO DE ROLAMENTO QUE FACILITA O FECHAMENTO E DIMINUI A PRÁTICA DE ESFORÇO; FÍSICO. POSSUI BANDEJAS CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, TOTALMENTE PERFURADAS PARA PERMITIR UMA BOA CIRCULAÇÃO DO VAPOR, GARANTINDO EXCELENTE QUALIDADE NA ESTERILIZAÇÃO. RESISTÊNCIA ELÉTRICA DE IMERSÃO, BLINDADA E FABRICADA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL. EQUIPAMENTO DE FÁCIL INSTALAÇÃO, NÃO REQUER INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL ONDE POSSIBILITA O REAPROVEITAMENTO DA ÁGUA, PERMITINDO VÁRIOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE REABASTECIMENTO. POSSUI MARCAÇÃO QUE POSSIBILITA VERIFICAR O NÍVEL MÍNIMO E MÁXIMO DE ÁGUA (CAPACIDADE DE 4,0 LITROS) E TAMPA COM CONDENSADOR DE VAPOR QUE DIMINUI O CONSUME DE ÁGUA DURANTE A EXECUÇÃO DE UM CICLO. VÁLVULA DE SEGURANÇA REGULADA PARA ATUAR COM PRESSÃO IGUAL OU SUPERIOR A MPTA (MÁXIMA PRESSÃO DE TRABALHO ADMISSÍVEL). SISTEMA ELÉTRICO DE SEGURANÇA COM FUSÍVEL DE PROTEÇÃO E TERMOSTATO DE SEGURANÇA PARA EVITAR A QUEIMA DAS RESISTÊNCIAS E DOS MATERIAIS EM CASO DE FALTA DE ÁGUA. PAINEL DE CONTROLE CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA, COM BOTÃO LIGA/DESLIGA ILUMINADA E INTERFACE ATRAVÉS DE TECLADO DE MEMBRANA E DISPLAY GRÁFICO CONSTRUÍDO COM COMPONENTES DE ALTÍSSIMA QUALIDADE E CONFIABILIDADE, COM FUNCIONAMENTO POR MEIO DE MICRO CONTROLADOR, POSSUI ÁREA DE VISÃO PARA VISUALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS E FASE DO PROCESSO. CONTROLE DE TEMPERATURA E DO TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO MOD. AB - 42</p>	UND	1	PHOENIX	R\$ 17.109,09	R\$ 17.109,09	dezessete mil, cento e nove reais e nove centavos	dezessete mil, cento e nove reais e nove centavos
TOTAL DO LOTE 03						R\$ 17.109,09	dezessete mil, cento e nove reais e nove centavos	

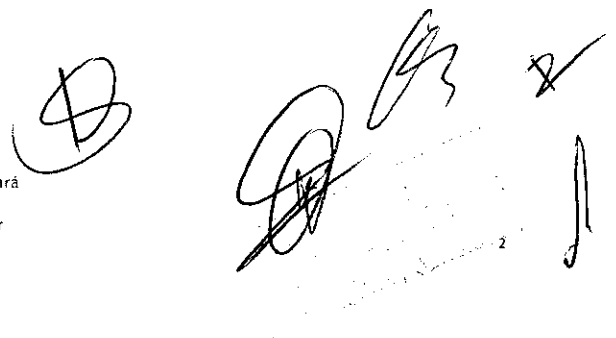



V

LOTE 04 - EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALARES								
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	V. UNT	V. TOTAL	VL. UNT Extenso	VL. TOTAL Extenso
1	CILINDRO DE OXIGÊNIO PORTÁTIL. CILINDRO PARA GASES MEDICINAIS, EM AÇO CARBONO NA COR VERDE, CONFORME NORMA DE IDENTIFICAÇÃO DE GASES DA ABNT, COM CAPACIDADE DE 3 LITROS. DEVE POSSUIR VÁLVULA E REGULADOR (MANÔMETRO E FLUXÔMETRO) PARA OXIGÊNIO. MOD. UM210A	UND	3	UNITEC	R\$ 1.888,07	R\$ 5.664,21	mil oitocentos e oitenta e oito reais e sete centavos	cinco mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos
2	CILINDRO DE OXIGÊNIO, CILINDRO PARA GASES MEDICINAIS, EM AÇO CARBONO NA COR VERDE, CONFORME NORMA DE IDENTIFICAÇÃO DE GASES DA ABNT, COM CAPACIDADE DE 10M3. MOD. CO910	UND	6	UNITEC	R\$ 4.637,93	R\$ 27.827,58	quatro mil, seiscentos e trinta e sete reais e noventa e três centavos	vinte e sete mil, oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos
3	RESPIRADOR MICROPROCESSADO (VENTILADOR PULMONAR) - RESPIRADOR MICRO PROCESSADO PARA ASSISTÊNCIA VENTILATÓRIA PERMITE SUSPIRO EM VC.V; POSSUI NEBULIZADOR (MICKRO NEBULIZAÇÃO) SINCRONIZADO; MISTURADOR DE GASES; AUTO TESTE PARA VERIFICAÇÃO DO SISTEMA, DA COMPLACÊNCIA DO CIRCUITO E VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS DO CIRCUITO; POSSUI VISUALIZAÇÃO DA EVOLUÇÃO (TENDÊNCIAS) DE ALGUNS PARÂMETROS MONITORIZADOS: 100 A 240 VOLTS AUTOMÁTICO, FREQUÊNCIA 50-60 HZ, EQUIPAMENTO DEVE ACOMPANHAR DOIS CONJUNTOS DE CIRCUITOS REUTILIZÁVEIS PARA PACIENTES ADULTOS, DOIS CONJUNTOS DE CIRCUITOS REUTILIZÁVEIS PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS, DOIS MASCARAS MASCAS; DUAS FÁCIAS ADULTO PEDIÁTRICO, MONTADO NO CARROZINHO DE RODÍZIO COM FREIOS, COM SISTEMA DE UNIDIFICAÇÃO TÉRMICA COM AJUSTE DA TEMPERATURA; 02 JARRAS PARA O SISTEMA DE UNIDIFICAÇÃO REUTILIZÁVEIS E AUTO-CLAVÁVEIS. MANOBRAS PARA CÁLCULO AUTOMÁTICO DE VALORES DA MECÂNICA RESPIRATÓRIA COMO COMPLACÊNCIA ESTÁTICA (CSR), CAPACIDADE VITAL (CV) E PRESSÃO INSPIRATÓRIA EM 100 MS (P.O. 1); AJUSTE DA ELEVAÇÃO DA ONDA DE PRESSÃO (PSE TIME) NAS MODALIDADES P.OV, P.OV, TEGIA PARA O2 A 100% COM REGRESSÃO AUTOCRÁTICA; MANÔMETRO DE PRESSÃO, MONITOR GRÁFICO, FLUXO OU VOLUME PELO TEMPO; E TACOS VOLUME X PRESSÃO E VOLUME X FLUXO COM RECURSO DE CONGELAR GRÁFICOS PARA UM MELHOR ESTUDO; INDICADOR NUMÉRICO PARA VOLUME CORRENTE BAIXO, VOLUME MINUTO ESPIRADO, VOLUME MINUTO TOTAL, FREQUÊNCIA TOTAL, RELAÇÃO I:E, PRESSÃO MÁXIMA (PIP), PLATÔ, MÉDIA (MAP) E ESPIRATÓRIA FINAL (PEEP); MEDIÇÃO DA FIO2 RESULTANTE NA SAÍDA DE GAS DO VENTILADOR PARA O PACIENTE COMPROVANDO A EFICÁCIA DA MISTURA AR/O2 AJUSTADA; AJUSTE DE ALARMES PARA ALTA PRESSÃO, BAIXA PRESSÃO, PRESSÃO DE PEEP BAIXA, VOLUME CORRENTE BAIXO, VOLUME CORRENTE ALTO, VOLUME MINUTO ALTO, VOLUME MINUTO BAIXO, FREQUÊNCIA ALTA E BATERIA FRACA; BATERIA INTERNA QUE FUNCIONA AUTOMATICAMENTE COM POCO MENOS 30 MINUTOS DE AUTONOMIA; MANOBRAS PARA CÁLCULO AUTOMÁTICO DE VALORES DA MECÂNICA RESPIRATÓRIA COMO COMPLACÊNCIA ESTÁTICA (CSR), CAPACIDADE VITAL (CV) E PRESSÃO INSPIRATÓRIA EM 100 MS (P.O. 1); AJUSTE DA ELEVAÇÃO DA ONDA DE PRESSÃO (PSE TIME) NAS MODALIDADES P.OV, P.OV, TEGIA PARA O2 A 100% COM REGRESSÃO AUTOCRÁTICA; MANÔMETRO DE PRESSÃO; MONITOR GRÁFICO, FLUXO OU VOLUME PELO TEMPO; E TACOS VOLUME X PRESSÃO E VOLUME X FLUXO COM RECURSO DE CONGELAR GRÁFICOS PARA UM MELHOR ESTUDO; INDICADOR NUMÉRICO PARA VOLUME CORRENTE ESPIRADO, VOLUME MINUTO ESPIRADO, VOLUME MINUTO TOTAL, FREQUÊNCIA TOTAL, RELAÇÃO I:E, PRESSÃO MÁXIMA (PIP), PLATÔ, MÉDIA (MAP) E ESPIRATÓRIA FINAL (PEEP); MEDIÇÃO DA FIO2 RESULTANTE NA SAÍDA DE GAS DO VENTILADOR PARA O PACIENTE COMPROVANDO A EFICÁCIA DA MISTURA AR/O2 AJUSTADA; AJUSTE DE ALARMES PARA ALTA PRESSÃO, BAIXA PRESSÃO, PRESSÃO DE PEEP BAIXA; VOLUME CORRENTE BAIXO, VOLUME CORRENTE ALTO, VOLUME MINUTO ALTO, VOLUME MINUTO BAIXO, FREQUÊNCIA ALTA E BATERIA FRACA; BATERIA INTERNA QUE FUNCIONA AUTOMATICAMENTE COM POCO MENOS 30 MINUTOS DE AUTONOMIA; ADULTO E PEDIÁTRICO E NEONATAL, COM AS MODALIDADES: A) VC.V (VOLUME CONTROLADO) NOS MODOS APC (A) e SIMV; B) VC.V (PRESSÃO FINAL) NOS MODOS A/C (B) e SIMV; C) CPAP (PRESSÃO CONTÍNUA EM VÍCIU) NA FAIXA DE 5 A 20 CMH2O; D) PEEP (PRESSÃO DE SUPORTE), E) E POCO MENOS UMA MODALIDADE DE CONTROLE MISTO QUE CONTROLE A PRESSÃO MAS GARANTA O VOLUME AJUSTADO EM CADA CICLO OU NO MINUTO, VOLUMES CORRENTES DE 10 A 2.400 ML; FREQUÊNCIA MANDATORIA QUE ATENDA A AJUSTE MÁXIMO DE POCO MENOS 200 RPM; AJUSTE DA CURVA DE FLUXO PARA ONDA QUADRADA, DESACELERADA, ACELERADA E SINUSOIDAL; PAUSA INSPIRATÓRIA QUE ATENDA A FAIXA ENTRE 0 E 7 SEGUNDOS; PEEP DE 0 A 50 CMH2O; AJUSTE DO NÍVEL DE PC QUE ATENDA A FAIXA ENTRE 3 A 70 CMH2O; AJUSTE DO NÍVEL DE PS QUE ATENDA A FAIXA ENTRE 10 A 40 CMH2O; AJUSTE PARA CICLAGEM (SENSIBILIDADE EXPIRATORIA) DA P.OV ATENDENDO A FAIXA ENTRE 10 A 40 CMH2O; DO NÍVEL DE FLUXO INSPIRATÓRIO; SENSIBILIDADE INSPIRATÓRIA POR MECANISMO DE FLUXO COM PROGRAMAÇÃO MÍNIMA DE POCO MENOS 0,5 L/MIN. COM IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA, MOD. LU17.3 (A1N)	UND	2	LEISTUNG	R\$ 76.909,09	R\$ 153.818,18	setenta e seis mil, novecentos e nove reais e nove centavos	cento e cinquenta e três mil, oitocentos e dezoito reais e dezoito centavos
TOTAL DO LOTE 04						R\$ 187.309,97	cento e oitenta e sete mil, trezentos e nove reais e noventa e sete centavos	

LOTE 09 - EQUIPAMENTOS								
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	V. UNT	V. TOTAL	VL.UNT Extenso	VL.TOTAL Extenso
1	LARINGOSCÓPIO COM KIT ADULTO - JOGO DE LARINGOSCOPIO ADULTO COM 9 LÂMINAS: CABO PARA LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓTICA (OU ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL), TAMANHO ADULTO, FABRICADO EM LATÃO CROMADO, ENCAIXE PADRÃO INTERNACIONAL, ALIMENTADO POR DUAS PILHAS MÉDIAS, LÂMPADA FACILMENTE SUBSTITUÍVEL. ACONDICIONADO EM ESTOJO APROPRIADO DE FORMA QUE GARANTA A PROTEÇÃO DO PRODUTO PRONTO PARA USO, COM MANUAL TÉCNICO CONSTANDO DE NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA. LÂMINA PARA LARINGOSCOPIO CURVA Nº 0, Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5 EM LATÃO CROMADO - CONVENCIONAL/ LÂMINA PARA LARINGOSCOPIO RETA Nº 0, Nº 1, Nº 2 EM LATÃO CROMADO CONVENCIONAL. MOD. FO	UND	2	MD	R\$ 3.539,29	R\$ 7.078,58	três mil, quinhentos e trinta e nove reais e vinte e nove centavos	sete mil e setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos
2	LARINGOSCÓPIO COM KIT INFANTIL - JOGO DE LARINGOSCOPIO INFANTIL COM 9 LÂMINAS: CABO PARA LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓTICA, TAMANHO INFANTIL, FABRICADO EM LATÃO CROMADO, ENCAIXE PADRÃO INTERNACIONAL, ALIMENTADO POR DUAS PILHAS PEQUENAS, LÂMPADA FACILMENTE SUBSTITUÍVEL. ACONDICIONADO EM ESTOJO APROPRIADO DE FORMA QUE GARANTA A PROTEÇÃO DO PRODUTO PRONTO PARA USO, COM MANUAL TÉCNICO CONSTANDO DE NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA. LÂMINA PARA LARINGOSCOPIO CURVA Nº 0, Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5 EM LATÃO CROMADO - CONVENCIONAL / LÂMINA PARA LARINGOSCOPIO RETA Nº 0, Nº 1, Nº 2 EM LATÃO CROMADO - CONVENCIONAL. MOD. FO	UND	2	MD	R\$ 3.539,29	R\$ 7.078,58	três mil, quinhentos e trinta e nove reais e vinte e nove centavos	sete mil e setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos
3	OFALMOSCÓPIO - BATERIA RECARREGÁVEL COM SELEÇÃO DE 5 ABERTURAS. 19 LENTES DE -20 A +20. M ARCADOR DE DIÓPTRIAS ILUMINADO. MOD. OMNI 3000	UND	1	HEINE	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	mil e duzentos reais	mil e duzentos reais
4	SELADORA DE MESA COM GUILHOTINA- AUTOMÁTICA- COMPRIMENTO DE SELAGEM: 30CM, LARGURA DA 4 SELAGEM: 10MM COM GUILHOTINA E PORTA ROLOS E B APLICAÇÃO GRAU CIRÚRGICO. CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL. MOD. PROTECT SEAL DIGITAL PLUS KIT 35CM	UND	1	AGIK	R\$ 1.307,27	R\$ 1.307,27	mil trezentos e sete reais e vinte e sete centavos	mil trezentos e sete reais e vinte e sete centavos
TOTAL DO LOTE 09						R\$ 16.664,43	dezesesseis mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos	

LOTE 11 - PERMANENTE ODONTOLOGIA								
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	V. UNT	V. TOTAL	VL.UNT Extenso	VL.TOTAL Extenso
1	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR) - CADEIRA UTILIZA PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. ACOMPANHA O EQUIPO, O SUGADOR E O REFLETOR. RMINAIS: NO MÍNIMO 3; CABECEIRA: ARTICULADA; COMANDO DA CADEIRA: PEDAL; EQUIPO: 1 ACOPLADO; REFLETOR: MULTIFOCAL (MAIS DE UMA INTENSIDADE); CUBA: PORCELANA/CERAMICA; UNIDADE AUXILIAR: 1 SUGADOR; SERINGA TRÍPLICE: POSSUI; CANETA DE ROTAÇÃO: POSSUI; CONTRA ÂNGULO: POSSUI; PEÇA RETA: POSSUI; MICRO MOTOR: POSSUI. MOD. ANGRA ACOPLADO	UND	2	LANZAM EDICAL	R\$ 15.727,27	R\$ 31.454,54	quinze mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos	trinta e um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos
TOTAL DO LOTE 11						R\$ 31.454,54	trinta e um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos	
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA						R\$ 285.428,94	DUZENTOS E OITENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS	

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

 PROPONENTE: LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI ME
 ENDEREÇO: AV. TREZE DE MAIO, 255A, FATIMA FORTALEZA - CEARA CEP: 60.040-530
 CNPJ: 03.183.450/0001-55 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.284.538-1
 BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº.:1369-2 CONTA CORRENTE Nº.: 27744-4
 EMAIL: LABTECNICA@LABTECNICA.COM.BR

TELEFONE: (85) 3283.5959


FABIO FURTADO DE SOUSA
CPF: 776.979.953-87

 Av. Treze de Maio, 255 - A
 Bairro: Fátima
 CEP: 60040-530 - Fortaleza - Ceará
 Contato: (85) 3283 - 5959
 E-mail: contato@labtecnica.com.br
 CNPJ: 03.183.450/0001-55

